



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L5772

检测报告

委托方： 厦门盈趣科技股份有限公司

生产单位： 厦门盈趣科技股份有限公司

样品名称： 一次性儿童防护口罩(F)

规格型号： YQ-PM02

检测类别： 委托检测

检测单位： 精准通检测认证（广东）有限公司

地址： 广东省东莞市东城街道同新路6号1栋





检测报告

报告编号: PTC20102805601C-CN01

报告日期: 2020年11月27日

第2页共7页

产品名称	一次性儿童防护口罩(F)	规格型号	YQ-PM02
		商标	/
样品等级	/	样品编号	/
检测类别	委托检验	货号/批号/款号	/
样品数量	/	接收状态	密封包装
收样日期	2020年10月30日 2020年11月25日	测试日期	2020年10月30日 ~ 2020年11月06日 2020年11月25日 ~ 2020年11月27日
检测环境说明	按标准要求		
委托单位及地址	厦门盈趣科技股份有限公司 厦门市海沧区东孚西路100号		
生产单位及地址	厦门盈趣科技股份有限公司 厦门市海沧区东孚西路100号		
检测依据	GB/T 38880-2020 儿童口罩技术规范		
检测项目	外观质量要求、甲醛含量、pH值、鼻夹长度、鼻夹耐折性、口罩带与口罩带与口罩体的连接处断裂强力、呼气阻力(未预处理)、吸气阻力(未预处理)、颗粒过滤效率(未预处理)、阻燃性能、尖端和边缘锐利性、包装、标识、安全警示		
检测结论	见检测结果		
备注	无		
编制: 万芷坤	审核: 张丽红	批准: 戴超美	



本报告是本公司遵循 www.ptc-testing.com 服务通用条款所出具。责任、保障和法律限制在服务通用条款已给了定义。

除非另有说明, 此报告结果只对样品负责。本报告未经许可, 不可部分复制

精准通检测认证(广东)有限公司

广东省东莞市东城街道同新路6号1栋

Tel: 86-769-38808222 Fax: 86-769-38826111 http:// www.ptc-testing.com



检测报告

报告编号: PTC20102805601C-CN01

报告日期: 2020年11月27日

第3页共7页

序号	检测项目/ 单位	检测方法	技术要求	检测结果		单项 评价	
1	外观质量要求	GB/T 38880-2020 条款 6.1	1、口罩与皮肤直接接触的内层材料不应印花或者染色; 2、口罩不应存在外露金属物,表面不应有破损、油污斑渍、变形及其他明显的缺陷。	符合		合格	
2	甲醛含量 (mg/kg)	GB/T 38880-2020 条款 6.3	≤20	N.D.		合格	
3	PH 值	GB/T 38880-2020 条款 6.4	4.0-7.5	6.5		合格	
4	鼻夹长度 (cm)	GB/T 38880-2020 条款 6.8	≥ 5.5	1	8.7	合格	
				2	8.8		
				3	8.8		
5	鼻夹耐折性	GB/T 38880-2020 条款 6.9	不应断裂	1	20 次后未断裂	合格	
				2	未断裂		
6	口罩带与口罩带与口罩体的连接处断裂强力(N)	GB/T 38880-2020 条款 6.10	≥15N	1	16.76	19.00	合格
				2	18.28	22.22	
				3	16.22	15.95	
				4	19.51	21.55	
				5	15.35	17.79	
7	呼气阻力 (Pa)	GB/T 38880-2020 条款 6.11	≤ 45	未预 处理	41.14	合格	
					37.11		
8	吸气阻力 (Pa)	GB/T 38880-2020 条款 6.12	≤ 45	未预 处理	29.36	合格	
					30.83		

本报告是本公司遵循 www.ptc-testing.com 服务通用条款所出具。责任、保障和法律限制在服务通用条款已给了定义。

除非另有说明,此报告结果只对样品负责。本报告未经许可,不可部分复制

精准通检测认证(广东)有限公司

广东省东莞市东城街道同新路6号1栋

Tel: 86-769-38808222 Fax: 86-769-38826111 http:// www.ptc-testing.com



检测报告

报告编号: PTC20102805601C-CN01

报告日期: 2020年11月27日

第4页共7页

序号	检测项目/ 单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项 评价	
9	颗粒过滤效率 (%)	GB/T 38880-2020 条款 6.14	≥ 95	未预 处理 (盐 性介 质)	96.98	合格
				96.72		
				97.32		
				98.27		
				97.47		
10	阻燃性能(阻燃 时间/S)	GB/T 38880-2020 条款 6.17	≤ 5	符合	合格	
11	尖端和边缘锐 利性	GB/T 38880-2020 条款 6.18	不应存在可触及的锐 利尖端和锐利边缘。	符合	合格	
12	包装	GB/T 38880-2020 条款 8.1	口罩应密封包装,方便 取用,并能避免使用前 被污染。	符合	合格	

本报告是本公司遵循 www.ptc-testing.com 服务通用条款所出具。责任、保障和法律限制在服务通用条款已给了定义。

除非另有说明,此报告结果只对样品负责。本报告未经许可,不可部分复制

精准通检测认证(广东)有限公司

广东省东莞市东城街道同新路6号1栋

Tel: 86-769-38808222 Fax: 86-769-38826111 <http://www.ptc-testing.com>



检测报告

报告编号: PTC20102805601C-CN01

报告日期: 2020年11月27日

第5页共7页

序号	检测项目/ 单位	检测方法	技术要求	检测 结果	单项 评价
13	标识	GB/T 38880-2020 条款 8.2	最小销售包装应有检验合格标识,明显部位应附有清晰可辨识的标识,标识应包含但不限于下列内容: 制造商名称和地址; 产品名称及类别[含“儿童防护口罩(F)”或“儿童卫生口罩(W)”字样]; 产品规格[小号(S)、中号(M)、大号(L)]; 主要原材料; 执行标准编号; 使用说明(佩戴方法、安全警示等); 生产日期、保质期、推荐使用时间(小时); 如采取消毒处理,应标明消毒方法。	符合	合格

本报告是本公司遵循 www.ptc-testing.com 服务通用条款所出具。责任、保障和法律限制在服务通用条款已给了定义。

除非另有说明,此报告结果只对样品负责。本报告未经许可,不可部分复制

精准通检测认证(广东)有限公司

广东省东莞市东城街道同新路6号1栋

Tel: 86-769-38808222 Fax: 86-769-38826111 [http:// www.ptc-testing.com](http://www.ptc-testing.com)



检测报告

报告编号: PTC20102805601C-CN01

报告日期: 2020年11月27日

第6页共7页

序号	检测项目/ 单位	检测方法	技术要求	检测 结果	单项 评价
14	安全警示	GB/T 38880-2020 条款 8.3	<p>口罩最小销售包装或说明书中应包括但不限于以下警示语:</p> <p>出现呼吸困难儿童不建议佩戴口罩,如需佩戴应遵医嘱或佩戴其他适合的呼吸防护用品。</p> <p>使用时应及时将口罩包装材料等与口罩佩戴无关的物件清理掉。</p> <p>儿童应在成年人看护下佩戴使用口罩,看护人应注意观察并教育儿童正确佩戴口罩。</p> <p>儿童佩戴口罩期间不应打闹或进行中等和中等以上强度运动,不应拆卸呼吸阀及呼吸阀内部件;如佩戴期间出现呼吸不适、皮肤过敏等症状,应及时摘脱口罩,必要时应立即就医。</p> <p>口罩应保持干燥,使用中避免沾湿,必要时应及时更换。</p> <p>口罩不建议洗涤后重复使用。</p> <p>已使用的口罩不应与他人交换。</p>	符合	合格

本报告是本公司遵循 www.ptc-testing.com 服务通用条款所出具。责任、保障和法律限制在服务通用条款已给了定义。

除非另有说明,此报告结果只对样品负责。本报告未经许可,不可部分复制

精准通检测认证(广东)有限公司

广东省东莞市东城街道同新路6号1栋

Tel: 86-769-38808222 Fax: 86-769-38826111 <http://www.ptc-testing.com>



检测报告


报告编号: PTC20102805601C-CN01

报告日期: 2020年11月27日

第7页共7页

- 注释:
1. N.D. = 未检测到。
 2. mg/kg = 毫克每千克(ppm)

样品照片:

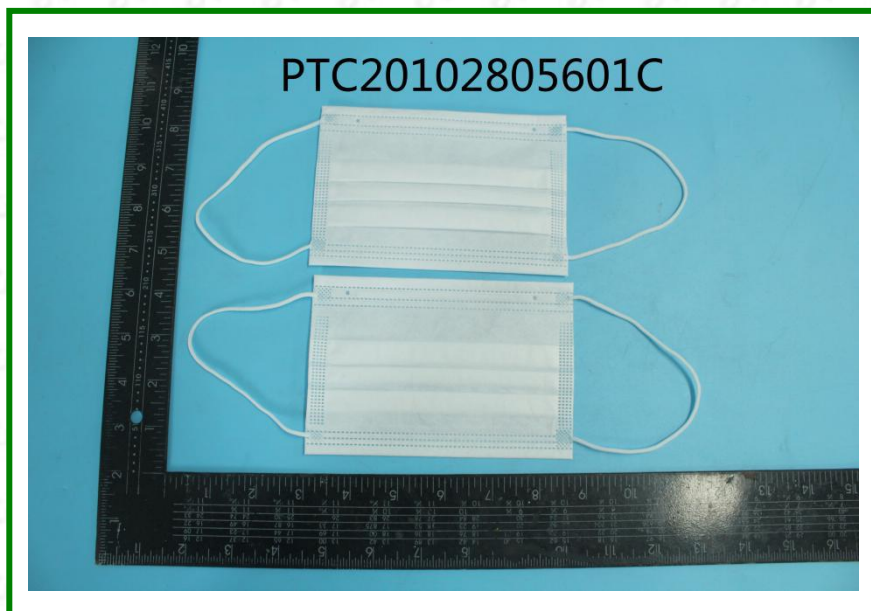

报告完

本报告是本公司遵循 www.ptc-testing.com 服务通用条款所出具。责任、保障和法律限制在服务通用条款已给了定义。

除非另有说明, 此报告结果只对样品负责。本报告未经许可, 不可部分复制

精准通检测认证(广东)有限公司

广东省东莞市东城街道同新路6号1栋

Tel: 86-769-38808222 Fax: 86-769-38826111 [http:// www.ptc-testing.com](http://www.ptc-testing.com)